


Philips VisaCare  
微晶探头替换装

敏感肌肤型

SC6890/02

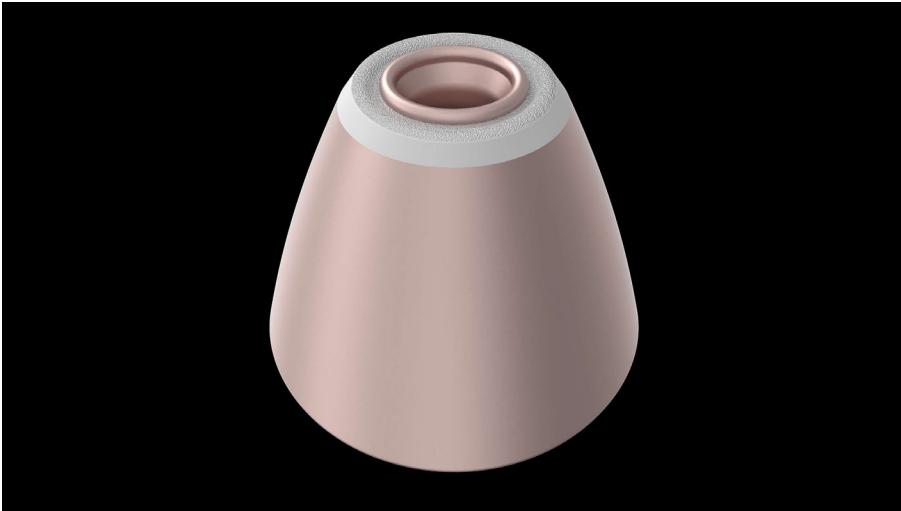

## 敏感肌肤型微晶探头替换装

仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用：在舒适的家中使用，产品结合去角质和真空提拉按摩系统，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。

### 易于替换去角质仪器头

- 轻松卡入式替换探头

### 适用于敏感皮肤的微晶探头

- 用于柔和护理的微晶磨皮仪器头
- 每 6 个月更换一次

**PHILIPS**

微晶探头替换装  
敏感肌肤型

# 规格

## 操作简易

- 适配：飞利浦 SC6220, 飞利浦 SC6240
- 肌肤类型：适用于敏感肌肤

- 清洁：用清水冲洗，用肥皂和刷子清洁
- 替换：轻松卡入式探头
- 建议更换时间：每 6 个月

SC6890/02

# 产品亮点

## 适用于敏感皮肤的微晶护理

建议首次使用微晶护理的女性，或敏感肌肤的，或因季节性或荷尔蒙失调导致肌肤更敏感的女性使用。与皮肤科专家共同研发，可在家中安全使用。使用新探头时，始终从有少量次数重新开始；让肌肤逐渐适应强力护理。\*

## 易于安装

易于安装，与飞利浦 SC6220 和 SC6240 兼容。

## 每 6 个月更换一次

为获得最佳效果，建议您每六个月更换一次微晶磨皮仪器头。



发行日期 2022-06-10

版本：6.1.1

EAN: 08 71010 36752 59

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*与每周使用两次，使用 6 个月的仪器头相比。