

PHILIPS

AVENT



Viengubas elektrinis įkraunamas

Natūralaus judėjimo technologija

Patogi silikoninė pagalvėlė

8 + 16 nustatymų



SCF396

Visas vienos krūties pientraukis

Greitas, patogus ir mylimas mamų

Pradėkite naująją erą su „Philips Avent“ elektriniu pientraukiu. Puikus siurbimo ir spenelių stimuliavimo balansas, įkvėptas kūdikio žindymo ritmo, o minkšta pagalvėlė švelniai prisitaiko prie jūsų spenelių dydžio ir formos. Daugiau informacijos rasite žemiau.

Pritaikytas ir lengvai naudojamas

- Tylus variklis netrukdo
- Sustabdykite, kada tik norite
- Izoliuotas krepšelis patogus keliaujant
- 8 stimuliavimo režimai, 16 nutraukimo režimų
- Pradėkite su ankstesnio seanso nustatymais
- Lengvai valoma ir surenkama, dėl mažesnio dalių skaičiaus

Švelnus ir patogus

- Minkšta silikoninė pagalvėlė yra patogi visiems

Greitas pieno nutraukimas, daugiau pieno per trumpesnį laiką*

- „Natural Motion“ technologija greitai skatina pieno išsiskyrimą*

Įkraunama baterija ir laikmačio ekranas

- Įkraunamas įrenginys nešiojamam laisvų rankų nutraukimui

Svarbu rasti tinkamą žinduką

Ypatybės

Greita pieno srovė*



Pienas gali pradėti tekėti vos per vieną minutę dėl mūsų unikalios „Natural Motion“ technologijos.** Dėl švelnaus fiksavimo ir tinkamo masažavimo bei siurbimo net 97 % motinų teigia, kad pienukio efektyvus***, o jį rekomenduoja 100 % akušerių.

Prisitaiko prie spenelio



Nepriklausomai nuo formos, pienukio minkšta lanksti silikoninė pagalvėlė patogiai prisitaiko prie krūties ir spenelio. Tinka 99,98 %**** krūtų dydžių***, prisitaiko švelniai, tačiau patikimai fiksacijai.


Svarbu rasti tinkamą žinduką



Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie

žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Nutraukimas keliaujant

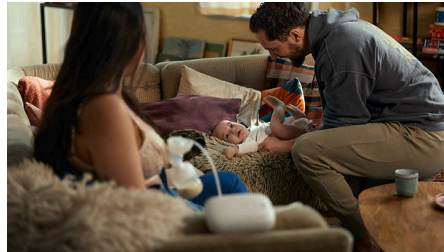


Kompaktiškas ir įkraunamas variklis. Taigi galite ruošti dienas (arba tiesiog pasidaryti puodelį arbatos), o jums netrukdytų įkūrūs maitinimo laidai.

Individualiai pritaikykite savo poreikiams



Geriausiai išnaudokite kiekvieną seansą su 8 pieno tekėjimo stimuliacijos režimais ir 16 nutraukimo režimų. Priderinkite eigoje.

Lengvai išvalykite ir nustatykite

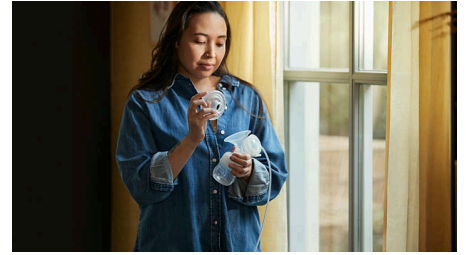


Sukūrėme nesudėtingą pienukį. Dėl mažesnio dalių skaičiaus jis greitai valomas ir surenkamas.

Nepastebimai nutraukite pieną bet kur



Mūsų pienukio variklis naudojimo metu praktiškai negirdimas. Todėl galite neblažkomai ir nepastebimai nutraukti namuose (ar bet kur kitur).


Pradėkite su ankstesnio seanso nustatymais

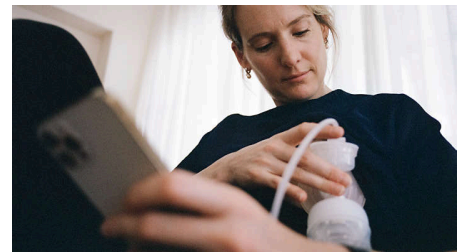

Atminties funkcija automatiškai išsaugo paskutinius stimuliacijos ir nutraukimo nustatymus. Tereikia patogiai įsitaisyti ir paspausti paleidimo mygtuką.

Ypatybės

Sustabdykite, kada tik norite

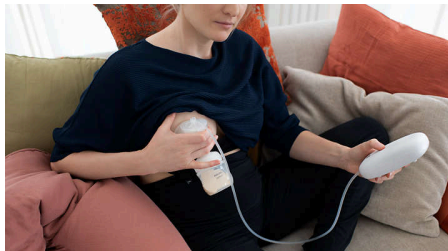

Jūs valdote viską – pristabdymas / paleidimas vienu prisilietimu leidžia pailsėti ir tęsti, kada tik norite.

Sekite nutraukimo laiką



Smulkmenos yra svarbios, pavyzdžiui, mūsų pientraukis seka nutraukimo laiką. Skaitmeniniame laikmačio ekrane galite stebėti, kiek laiko nutraukiate iš vienos krūties ir kiek iš viso.

Izoliuotas krepšelis



Kad ir kur naudotumėte pientraukį, pritaikytas krepšelis padės jums, nes jūsų rinkinys bus izoliuotas ir tvarkingai sudėtas. Stilingą audinį lengva valyti tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

Specifikacijos

Maitinimas

Tinklo įtampa: 100V - 240 V

Medžiaga

Pientraukis: Be BPA* (tik su maistu besiliečiančios dalys)

Kas pridedama

Vienkartinis krūtų įklotas: 4 vnt.

Pieno nutraukimo komplektas: 1 vnt.

„Micro-USB“ adapteris: 1 vnt.

Variklis (įkraunamas): 1 vnt.

Sandarinimo diskas: 1 vnt.

Pieno maišeliai: 5 vnt.

Kelioninis krepšelis: 1 vnt.

Funkcijos

Minkšta ir pritaikoma pagalvėlė: Švelnus stimuliuojimas



* Remiantis rezultatais iki pradedant tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo reflekso – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).

* *1K-SE: 70 % dalyvių patyrė MER per 60 sekundžių. Remiantis rezultatais iki pradedant tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo reflekso – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).

* **Remiantis klinikinio produkto tyrimo su 20 dalyvių rezultatais (Nyderlandai, 2019 m.), vidutinis viengubo ir dvigubo elektrinio pientraukio įvertis; 95 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (viengubi elektriniai); 100 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (dvigubi elektriniai).

* ***Remiantis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas pirmąją laktacijos savaitę. Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužės mėn., (20 dalyvių (baltųjų), JAV); (3) Ramsay et al. Žindomos krūties anatomija, iš naujo apibūdinta ultragarsu, 2005 m. (28 dalyviai, Australija).

* ****Taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011.