

PHILIPS

AVENT



ערכה של משאבת חלב

Double Breast Pump
Kit

כרית סיליקון נוחה

ערכה נוספת לנוחות

קלה לניקוי, מהירה להרכבה

השתמשי עם יחידות מנוע של
Philips Avent משאבת החלב של



SCF335/12

ערכת המשאבה הכפולה השלמה

ערכה נוספת לנוחות מוגברת

הערכות של משאבות החלב שלנו מיוצרות עם איזון מושלם בין שאיבה לבין גירוי הפטמה. הן מגיעות עם כריות סיליקון שמתאימות את עצמן לגודל ולצורה של הפטמה בעדינות לקבלה של חוויית שאיבה יעילה ונוחה יותר.

נייד וקל לשימוש

- לנקות ולהרכיב בקלות עם מספר חלקים קטן
- שאיבת חלב בלי לרכון קדימה

עדין ונוח

- כרית סיליקון רכה מציעה נוחות לכל גוף

שאיבה מהירה: יותר חלב בפחות זמן

- מזרימה חלב במהירות Natural Motion Technology*

Highlights

זרימת חלב מהירה




החלב מתחיל לזרום תוך דקה לכל היותר, הודות עם **Natural Motion Technology לטכנולוגיית תפיסה קלה ועם רמה מדויקת של עיסוי וניקה, אין פלא ש-97% מהאמהות אומרות שהמשאבה אפקטיבית***, ו-100% מהמיילדות ממליצות עליה.

התאימי אותה לפטמה



לא משנה הצורה, כרית הסיליקון הרכה והגמישה של המשאבה נוחה לשימוש כנגד השד והפטמה. מתאימה ל-99.98% מגודלי השדיים****, מסתגלת לקבלת תפיסה רכה ומאובטחת.

קל לניקוי ופשוט להתקנה

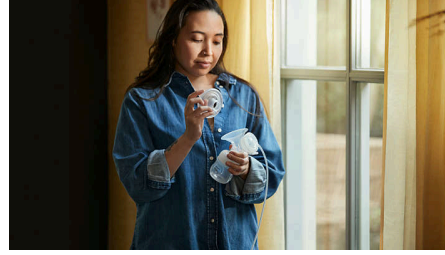

עיצבנו את המשאבה בצורה נטולת סיבוכים, עם מספר חלקים קטן כדי שתהייה קלה לניקוי ולהרכבה.

ישיבה נוחה



להירגע בזמן ההזרמה - הודות לעיצוב שלנו, המאפשר ישיבה זקופה, בלי לרוכך קדימה.

Specifications

חומר

BPA**** ערכת שאיבה: נטול

מה כלול

ערכת שאיבה עם צנרת: 2 ערכות
'בקבוק 4 אונקיות נוזלים (125 מ"ל): 2 יח
'טבעת הברגה: 2 יח
'מכסה איטום: 2 יח

פונקציות

כרית רכה וגמישה: גירוי עדין

תאימות

השתמשי רק בשילוב עם: Philips Avent SCF391, SCF392, SCF393, SCF394, SCF395, SCF396, SCF397, SCF398, SCD330, SCD340, SCD395

זמן עד לרפלקס) מבוסס על תוצאות זמן התחלת זרימת החלב * ממחקר קליני שנערך בקרב 20 משתתפות (MER - שחרור החלב רפלקס שחרור) MER (הולנד, 2019) בהשוואה לתוצאות הזמן של באמצעות טכנולוגיית שאיבה אחרת של פיליפס. ממחקר (החלב היתכנות שנערך בקרב 9 משתתפות (הולנד, 2018) תוך 60 שניות. מבוסס MER 70% מהמשתתפות חוו SE-אעבור *1 זמן עד לרפלקס שחרור) על תוצאות זמן התחלת זרימת החלב ממחקר קליני שנערך בקרב 20 משתתפות (הולנד, MER - החלב באמצעות טכנולוגיית MER 2019) בהשוואה לתוצאות הזמן של שאיבה אחרת של פיליפס ממחקר היתכנות שנערך בקרב 9 משתתפות (הולנד, 2018).

מבוסס על תוצאות הניסוי הקליני למוצר עם 20 משתתפות*** (הולנד, 2019), הניקוד הממוצע עבור משאבת חלב חשמלית יחידה וכפולה; 95% מהמשתתפות הסכימו שמשאבות החלב שלנו יעילות (חשמלית יחידה); 100% מהמשתתפות מסכימות שמשאבות החלב שלנו יעילות (חשמלית כפולה).

ואחרים, קשיים בהנקה, משך ההנקה, Mangel מבוסס על: (1)*** הם אינדקס מסת הגוף של אמהות ואנטומיה של השד: האם הם 26 באפריל 2019, 109) Breastfeeding Medicine, קשורים ואחרים, שינויים בעור וכאב Ziemer משתתפות, ישראל; (2) Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 20, 1993, בפטמה במהלך השבוע הראשון של תקופת ההנקה מאי 1993, 20) Ramsay מחדש משתתפות (לבנות), ארה"ב; (3) ואחרים, הגדרה מחדש של השד האנושי בהנקה בעזרת דימות של האנטומיה של השד האנושי בהנקה בעזרת דימות אולטרסאונד, 2005 (28 משתתפות, אוסטרליה).

קשורה רק לבקבוק ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב**** * EU, 10/2011. בהתאם לתקנת

