



PHILIPS

Optimisez le flux de travail
avec Elevate Plus

Elevate Plus pour EPIQ Elite et Affiniti

IA et automatisation de pointe à votre service

Notre IA et notre automatisation de pointe ainsi que d'autres améliorations du flux de travail, vous aident encore davantage à accélérer le débit de patients.

EPIQ Elite Elevate Plus

Ecran HD MAX
40%
plus lumineux
que la technologie
d'affichage OLED¹




Consomme **29%**
d'énergie en moins²

Affiniti Elevate Plus



Consomme **37%**
d'énergie en moins³

Elevate Plus pour EPIQ Elite et Affiniti



Mesure automatique de l'abdomen

pour un temps de mesure réduit de 55 %^{4,5}



Ergonomie exceptionnelle

avec plusieurs degrés d'articulation pour le panneau de commande et le moniteur, offrant 720° de liberté pour un confort d'examen optimal



Auto Scan Nouvelle Génération

améliore l'uniformité de l'image, en réduisant jusqu'à 54 % le nombre d'appuis sur les boutons grâce à une optimisation pixel par pixel en temps réel⁸



Préréglages de lancement rapide

offrent une diminution de 55 % des appuis sur les boutons lors d'un examen abdominal¹⁰



SmartExam

améliore le flux de travail de l'utilisateur grâce à des protocoles guidés par le système, facilement personnalisables



Batterie de secours

permet un démarrage quasi instantané grâce à une autonomie de batterie de 45 minutes



Auto ElastQ

réduit jusqu'à 60 % le temps d'examen du foie⁶



Auto Cine 2D et Auto Cine Couleur

pour une sélection stable des images sans effort et un temps réduit de 68,9 % pour acquérir des images correctes du premier coup⁷



Interface utilisateur intuitive type tablette

réduit considérablement la portée et le nombre d'appuis sur les boutons, avec 40 à 80 % de portée en moins et 15 % d'étapes en moins⁹



Imagerie plein écran MaxVue

pour 38 % de surface d'affichage en plus




Commandes de post-traitement

incluant désormais le gain — réduisent le besoin de refaire des examens : 84 % des utilisateurs ont indiqué qu'il était possible d'éviter de rescanner le patient lorsque la qualité d'image était jugée insatisfaisante en raison de réglages d'image inappropriés¹²

Auto Doppler

ajuste la sensibilité et la résolution optimales du flux, en réduisant 10 étapes à 3 étapes et avec 68 % d'appuis sur les boutons en moins¹³

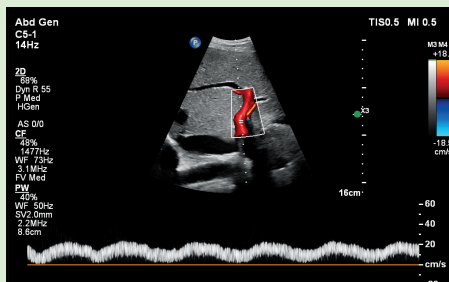

Doppler de la veine porte du foie avec la sonde C5-1



Nombre d'appuis sur les boutons réduit de **68%**¹³



1. Internal specification comparison of OLED on EPIQ CVx versus EPIQ HD MAX.
2. Philips EPIQ Elite US EcoPassport.
3. Compared to predecessor HD11 XE. Affiniti EcoPassport
4. Internal documentation: Validation report D001785669. Evidence was obtained on a subset of data from 5 subjects (7 clinical experts) assessing the measurement time for saved images and not the scan time.
5. Available on EPIQ Elite, Affiniti 70, Affiniti 50.
6. Internal documentation. Validation report D001526983, Claims list, VM12.0, Rev D.
7. Internal documentation: Validation report D001785669. 68.9% (from 15.6% to 84.4%) increased rate of first-time-right images in abdominal scanning using Auto Cine.
8. When comparing release 10 performance to release 7 performance.
9. 2013 engineering study comparing Philips iU22 ultrasound system with EPIQ.
10. D001833994, Marketing Claim Evidence for Release 12.0 Workflow Efficiency Quick Launch Preset.
11. Compared to our previous monitor without MaxVue.
12. This is based on a sample size of n=37 users and is not statistically powered.
13. Philips Auto Doppler Clinical Study, Dec. 2011

Les systèmes EPIQ et Affiniti sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI CE2797. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Mai 2026

