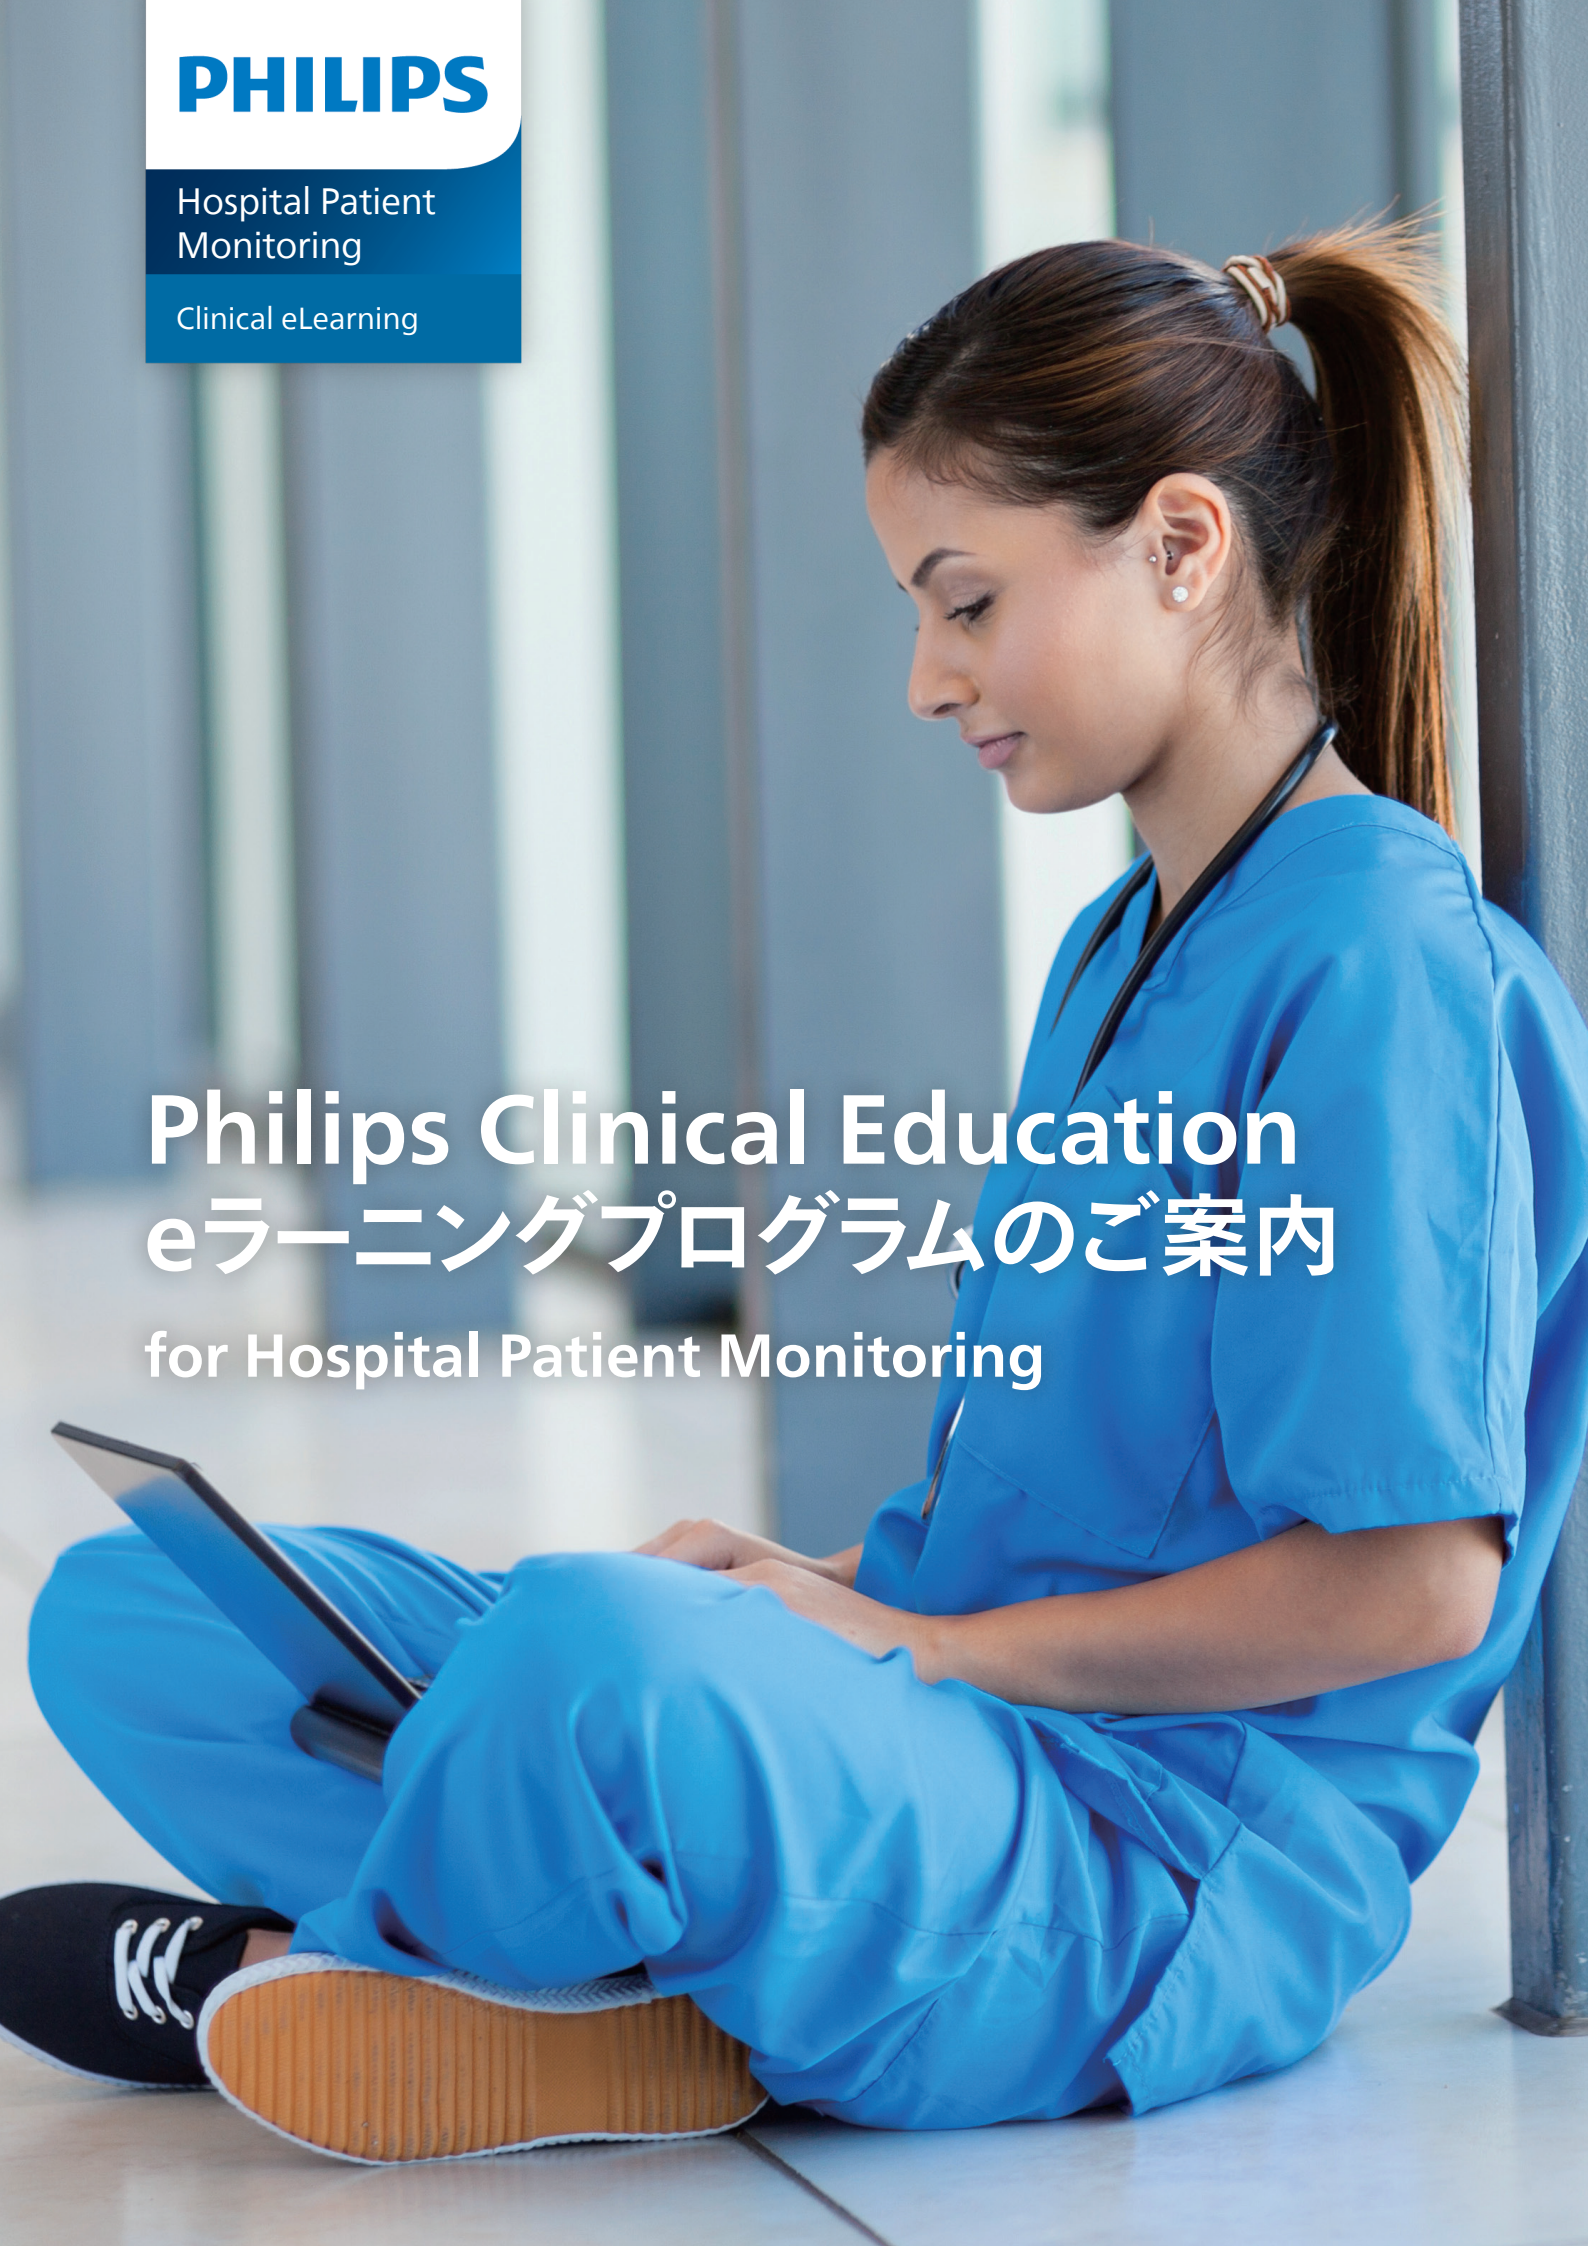


A healthcare professional, likely a nurse or doctor, is sitting on the floor in a hospital corridor. She is wearing blue scrubs and has a stethoscope around her neck. She is looking down at a laptop computer that is open on her lap. The background shows a blurred hospital hallway with vertical lines from the walls and floor.

PHILIPS

Hospital Patient
Monitoring

Clinical eLearning

Philips Clinical Education eラーニングプログラムのご案内 for Hospital Patient Monitoring

いつでも どこでも フレキシブルな学びを Flexible learning anytime, anywhere

医療従事者は、その専門分野の最新知識を常に学習することが重要です。
多忙なスケジュールの中で学習時間を確保することは難しいかもしれません。
Philips Learning Center (PLC) は、デジタルトランスフォーメーションによる新たな学習方法を提案します。
継続的な教育プログラムをいつでも、どこでも学習できるよう
スマートフォン、タブレット、パソコンから簡単にアクセスすることができます。

Philips Clinical Education eラーニングプログラム

フィリップスのモニタリングソリューションは、すでに多くの施設でご利用いただいています。
基本的な生体情報モニタの知識や各製品向けの機能説明やソリューションの最適化に関するトレーニングをご提供いたします。
ルーティン運用にも役立てていただけるように教材も継続的にアップデートしていきます。

アラームマネジメント

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・重大度の異なるアラームの識別
- ・アラームの消音 / 中断
- ・アラームの設定の調整
- ・アラーム設定値の調整: 心房細動
- ・アラーム設定値の調整: NBPおよびHR



不整脈モニタリング

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・不整脈解析をOn/Offにする方法
- ・QRS波の評価方法
- ・不整脈解析に最適な誘導の選択方法



呼吸モニタリング

このコースで学習する内容は次のとおりです。


- ・誘導配置、検出モードの変更、波形サイズの変更




酸素飽和度 (SpO₂) モニタリング

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・SpO₂モニタリングの設定、SpO₂信号品質の評価
- ・QRS音量の調整

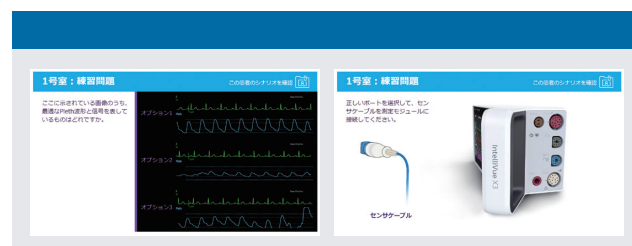

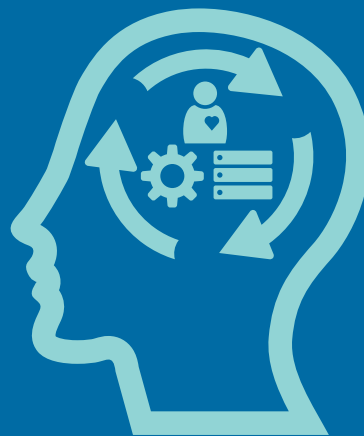

Interested in learning more?

ECGモニタリングの最適化

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・皮膚の処置、ECG誘導の選択、拍動ラベルの確認
- ・不整脈解析モードの切り替え



体温モニタリング

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・体温数値の変更
- ・正しい体温ラベルの選択



観血血圧モニタリング

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・血圧ラベルの調整、スケールの変更と最適化
- ・トランスジューサのゼロ校正、観血血圧モニタリングの終了



非観血血圧モニタリング

このコースで学習する内容は次のとおりです。

- ・正しいカフのサイズと配置の決定、血圧測定の開始
- ・NBP測定間隔とモードの変更、NBPアラーム設定とソースの調整、NBP測定記録のレビュー





製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

お客様窓口 0120-556-494
03-4334-7637

受付時間 9:00～18:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

www.philips.co.jp/healthcare

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

販売名：生体情報モニタ IntelliVue
医療機器承認番号：22000BZX00725000
特定保守管理医療機器 / 高度管理医療機器

販売名：生体情報モニタ IntelliVue X3/MX100 2nd
医療機器承認番号：23100BZX00080000
特定保守管理医療機器 / 高度管理医療機器

販売名：セントラルモニタ フィリップスインフォメーションセンタ
医療機器承認番号：30200BZX00351000
高度管理医療機器

販売名：セントラルモニタ フィリップス患者情報センタ
医療機器承認番号：22200BZX00715000
特定保守管理医療機器 / 高度管理医療機器



本プログラムについては、こちらの二次元コードからお問い合わせください。